



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento

ac

DELIBERAZIONE N. 492 DEL

17 MAR. 2021

OGGETTO: esito procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchio Radiologico portatile Digitale Diretto per la gestione in emergenza di pazienti affetti da Coronavirus (2019-nCoV). Importo € 73.290,00 IVA 5% inclusa.

L'anno duemilaventuno addì 17 del mese di MAR. presso la sede amministrativa dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, sita in Genova Largo Rosanna Benzi, 10, presenti il Direttore Scientifico, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario f.f.,

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Determinazione n. 1128 del 15.05.2020 con la quale è stato disposto di esperire apposita procedura di acquisto negoziata tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, modificato con D.Lgs n. 56/2017, per l'affidamento della fornitura di n. 1 Apparecchio Radiologico portatile Digitale Diretto da destinare all'area di Emergenza del Pronto Soccorso per la gestione in emergenza di pazienti affetti da Coronavirus (2019-nCoV);

- vista la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - o dati generali della procedura RDO n. 2570342 – "Apparecchio Radiologico portatile Digitale Diretto";
- precisato che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte (10.06.2020) sono pervenute le offerte delle ditte General Medical Merate spa e Siemens Healthcare srl e che in data 11.06.2020 si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa presentata da cui è emerso che le ditte partecipanti sono state ammesse alla gara;
- richiamata la Determinazione n. 1470 del 02.07.2020 di nomina della Commissione Tecnica appositamente costituita per l'esame della documentazione tecnica ed attribuzione dei relativi punteggi;
- esaminata la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:


- verbale in seduta riservata del 23.11.2020 della Commissione Tecnica, incaricata di procedere alla valutazione della conformità della documentazione presentata dalle ditte concorrenti con quanto richiesto dalla lex specialis di gara, dal quale sono risultate ammesse alle successive fasi di gara le sopra citate ditte ed è stato conferito mandato all'U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento di richiedere alle stesse la presentazione delle apparecchiature in prova per la relativa valutazione;
- verbale in seduta riservata del 01.03.2021 della Commissione Tecnica durante la quale sono stati attribuiti i punteggi per ciascun parametro valutativo a seguito delle valutazioni delle offerte tecniche e delle prove pratiche effettuate;
- preso atto dell'apertura pubblica (telematica) delle offerte economiche, conclusa in data 05.03.2021 sul portale del Mepa da cui è risultato che la ditta General Medical Merate spa ha conseguito un punteggio complessivo di punti 100 su 100 risultando quindi aggiudicataria della procedura proponendo la fornitura in oggetto al prezzo complessivo di € 69.800,00 IVA esclusa come da riepilogo esame delle offerte ricevute allegato;
- considerato che, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. N. 50/2016, l'offerta della ditta General Medical Merate spa è risultata anomala;
- precisato che, con l'allegata nota prot. 10782 del 08.03.2021 è stato chiesto alla ditta General Medical Merate spa di produrre le opportune giustificazioni relativamente alle condizioni che hanno consentito di formulare l'offerta con lo sconto sopra specificato;
- accertato che con l'allegata comunicazione acquisita agli atti con prot. n. 11441 del 10.03.2021 la ditta General Medical Merate spa ha motivato le condizioni tecnico/economiche che le hanno consentito di formulare l'offerta ad un prezzo sotto la soglia dell'anomalia;
- preso atto che i costi relativi alla presente procedura sono soggetti all'imposizione dell'IVA al 5% ex art. 124 del Decreto "Rilancio" N. 34 del 19.05.2020;
- ritenuto pertanto di affidare alla ditta General Medical Merate spa, la fornitura di un Apparecchio Radiologico portatile Digitale Diretto mod. Accord DR 40 alla quotazione di € 69.800,00 IVA esclusa come da offerta allegata;
- dato atto che i costi di cui al presente provvedimento, pari complessivamente a € 73.290,00 comprensivi di IVA al 5% sono imputati al conto patrimoniale 010 020 005;
- su conforme proposta del Direttore della U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento;
- preso atto del parere favorevole espresso, per quanto di competenza, dal Direttore Scientifico, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario f.f.,

DELIBERA

- di aggiudicare alla ditta General Medical Merate spa la procedura negoziata tramite RdO sul "Mercato elettronico della P.A." per la fornitura di un Apparecchio Radiologico


portatile Digitale Diretto mod. Accord DR 40, da destinare all'area di Emergenza del Pronto Soccorso per la gestione in emergenza di pazienti affetti da Coronavirus (2019-nCoV), per un importo complessivo pari ad € 69.800,00 IVA esclusa;

- di dare atto che i costi di cui al presente provvedimento, pari complessivamente ad € 73.290,00, comprensivi di IVA al 5% ex art. 124 del Decreto "Rilancio" N. 34 del 19.05.2020, sono imputati al conto patrimoniale 010 020 005.


Il Direttore Proponente
U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento
(Dott.ssa Stefania Rizzuto)

Effettuata Registrazione n. 2020/1041/87
Sul C.P. 010 025 005 per € 73.290,00

Il Direttore U.O. Bilancio e
Programmazione Finanziaria
(Dott. Fabrizio Figallo)




Il Direttore Amministrativo
(Dott. Fabrizio Figallo)


Il Direttore Sanitario f.f.
(Dott. Giovanni Orengo)


Il Direttore Scientifico
(Prof. Antonio Uccelli)


Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Giuffrida)

Invio Rdo.

1/5

in pa

OK

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2570342
Descrizione RDO:	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Amministrazione titolare del procedimento	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 02060250996 LARGO ROSANNA BENZI, 10 GENOVA GE
Punto Ordinante	STEFANIA RIZZUTO
Soggetto stipulante	Nome: STEFANIA RIZZUTO Amministrazione: IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Codice univoco ufficio - IPA	Non disponibile
Inizio presentazione offerte:	19/05/2020 10:57
Termine ultimo presentazione offerte:	10/06/2020 18:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	29/05/2020 18:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2020 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	60
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della Rdo e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Data Creazione Documento: 19/05/2020 10:58

1 alla deliberazione n° 147 del 17 MAR 2021
5 pagine numerate da 1 a

Pagina 1 di 5

Numero fornitori invitati:	8
-----------------------------------	---

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO
CIG	827301866C
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	Non Lineare a Proporzionalita' inversa (interdipendente)
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	Non specificati
Dati di consegna	Largo rosanna benzi 10Genova - 16129 (GE)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	82000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Nome commerciale del sensore per radiologia digitale	Tecnico	Nessuna regola	
2	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
3	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
4	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
CONDIZIONI PARTICOLARI	Gara	Condizioni Particolari.pdf (480KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
ALLEGATO M7 (GDPR)	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	No
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ART. 4 COMMA A) DELLE CONDIZIONI PARTICOLATI	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	No
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	No
DESCRIZIONE TECNICA PRODOTTO OFFERTO	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	No
DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA PRODOTTO OFFERTO	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	No
OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	No
QUESTIONARIO TECNICO COMPILATO	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	No

SCHEDA ASSISTENZA POST-VENDITA COMPILATA	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	No
LISTINO PREZZI IN CORSO DI VALIDITA'	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO	Economica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	No
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	ESAOTE S.P.A.	05131180969	05131180969	GENOVA(GE)	LIGURIA	SCELTO
2	EUROCOLUMBUS	00840200158	00840200158	MILANO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
3	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	03663500969	93027710016	MILANO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
4	GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	00225500164	00225500164	SERiate(BG)	LOMBARDIA	SCELTO
5	GILARDONI S.P.A.	00734000151	00734000151	MILANO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
6	ITALRAY	00892270489	00892270489	SCANDICCI(FI)	TOSCANA	SCELTO
7	PHILIPS	00856750153	00856750153	MILANO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO
8	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	12268050155	04785851009	MILANO(MI)	LOMBARDIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.

50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

VERBALE 1

FORNITURA DI UN APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE
DIRETTO
(R.D.O. 2570342)

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di novembre alle ore 10.00 presso la sala riunioni dell'U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento di questo Policlinico, sita al primo piano del Padiglione Cotella, si procede alle operazioni di gara relative alla procedura per l'affidamento della fornitura di apparecchio radiologico portatile digitale diretto.

Nel giorno e nell'ora di cui sopra sono presenti i componenti della Commissione Tecnica nominata con determinazione n. 1470 del 02/07/2020 e segnatamente:

PRESIDENTE:	Dott.ssa D. Passerini	Dirigente Medico U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera;
COMPONENTI	Dott. G. Minetti	Dirigente Medico U.O. Radiologia Interventistica
	Ing. M. Saddemi	Dirigente Ingegnere U.O. ICT;
SEGRETERIA	Dott.ssa V. Bertarini	Ass.te Amm.vo U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento

Il Presidente della Commissione, verificata la regolarità della costituzione essendo presenti tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione ha potuto convocarsi solo in data odierna in considerazione delle problematiche legate all'emergenza Covid-19, dei concomitanti impegni istituzionali dei componenti della Commissione e in considerazione del fatto che alcuni di essi, nello stesso periodo, hanno partecipato ai lavori di altre commissioni di gara.

Allegato 2 alla deliberazione n° 192 del
10 pagine numerate da 1 a

17 MAR. 2021

VP

MG

La Commissione, presa visione del Capitolato Speciale di gara, accerta che la aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri meglio specificati all'art. 5- MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE del succitato Capitolato speciale e segnatamente:

- all'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 70 sulla base dei parametri indicati nel questionario tecnico
- all'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di punti 30

La Commissione dà atto ed accerta che entro il termine per la scadenza della presentazione delle offerte, previsto per il 10/06/2020 hanno presentato offerta, le seguenti ditte:

- GMM SPA
- SIEMENS HEALTHCARE SRL

Tutti i componenti della Commissione dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità personale e/o professionale con le suddette ditte e con i relativi soci, amministratori e rappresentanti.

La commissione, stabilisce di procedere con la verifica del rispetto da parte delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti, delle caratteristiche definite come "necessarie" dalla lex specialis di gara e alla conseguente eventuale ammissione delle stesse alle successive fasi di gara.

Pertanto, il collegio provvede alla verifica della documentazione presentata da ciascuna Ditta:



Ditta GMM

La Commissione accerta che l'apparecchiatura proposta dalla Ditta risponde a tutte le caratteristiche richieste dalla documentazione di gara come indicato nell'allegato prospetto.

La ditta, pertanto, risulta essere **AMMESSA** alle successive fasi di gara.

Si procede, dunque, all'esame della documentazione presentata dalla Ditta:

Ditta SIEMENS

VB. M.  

La Commissione accerta che l'apparecchiatura proposta dalla Ditta risponde a tutte le caratteristiche richieste dalla documentazione di gara come indicato nell'allegato prospetto.

La ditta, pertanto, risulta essere **AMMESSA** alle successive fasi di gara.

La Commissione, pertanto, decide di dare mandato all'U.O. Attività economali e di approvvigionamento di richiedere alle ditte ammesse alle successive fasi di gara di presentare l'apparecchiatura per la prova pratica così come previsto dalla documentazione di gara.

La Commissione riunirsi in data da destinarsi per la prosecuzione dei lavori (attribuzione punteggi qualitativi) al termine della prove pratica.


Alle ore 11.20 la Commissione decide di terminare i suoi lavori.

Letto, confermato e sottoscritto



IL PRESIDENTE




I COMPONENTI





FORNITURA APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE		
	GMM	SIEMENS HEALTHCARE
DATI GENERALI DELL'APPARECCHIATURA		
destinazione d'uso	indagini diagnostiche ed esami radiologici in regime di radiografia	apparecchio portatile digitale per radiografie
fabbricante	TECHNIX SPA	Siemens Helathcare Gmbh - Erlangen - Germania
Modello	ACCORD DR40	Mobilett Elara
Distributore	General Medical Merate SPA	Siemens Healthcare Srl
Anno di inizio produzione	2016	2019
Codice CIVAB (se applicabile)	n.a.	n.d.
Classificazione CND (obbligatorio)	Z11039016	Z11039016
N.ro di repertorio RDM (obbligatorio)	1424412	1808986
Classificazione GMDN	n.a.	37647
Conformità 93/42/CE e s.m.i. (47/2007) e relativa classificazione (I, IIa, IIb, III) – ALLEGARE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	Vedi documentazione allegata	Classe lib
Classificazione CEI (classe, Tipo)	Calssse I tipo B	classe 1 - parte applicata tipo B(detettore)
Ingombro (LxPxH)	120,4x57,6x135,4 cm	59,5x127,5x157 cm
Peso totale (Kg)	435 kg	380Kg
Alimentazione elettrica (monofase, trifase)	monofase 50/60Hz	monofase
caratteristiche di alimentazione elettrica (V, A, VA)	230V +/- 10% - 10A max - 2300VA	100 V a 240V 50/60 Hz
Potenza elettrica assorbita in stand by e in funzionamento (KW)	n.a.	variabile , max 1,2 KW


 VB 

FORNITURA APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE		
Necessità di continuità della alimentazione elettrica (gruppo di continuità, stabilizzatore, altro). NB: in caso di necessità il dispositivo deve essere incluso nell'offerta senza ulteriori oneri	no	no
Norme CEI di riferimento	non presenti	IEC 60601- 1-2 ed.4
Conformità D.Lgs. 81/2008 e s.m.i (OBBLIGATORIO) - Indicare la necessità di particolari DPI previsti per l'uso	si conformità d.lsg 81/08 vedasi manuale operatore	si guanti monouso occhiali camici manica lunga monouso
In dicare se esistenti requisiti particolari/predisposizioni di cui devono disporre i locali destinati ad accogliere il dispositivo. NB: in caso di necessità tali adeguamenti dovranno essere realizzati dall ditta senza ulteriori oneri per il Policlinico	no	no
N.B. in caso di necessità tali adeguamenti dovranno essere realizzati dalla Ditta senza ulteriori oneri per il Policlinico	n.a.	no
n.ro dispositivi analoghi venduti sul territorio nazionale	36	53
Certificazione del sistema qualità in possesso del fabbricante (es. ISO 9000:2001)	si	vedi allegata documentazione
Certificazione del sistema qualità in possesso del distributore (es. ISO 9000:2001)	si	vedi allegata documentazione
necessità di schermature per disturbi elettromagnetici e a radiofrequenza (si/no, se si descrivere). Gli eventuali adeguamenti impiantistico strutturali che dovessero rendersi necessari saranno a carico del fornitore	no	no
necessità particolari condizioni di funzionamento (descrivere). Gli eventuali adeguamenti impiantistico strutturali che dovessero rendersi necessari saranno a carico del fornitore	no	no
CARATTERISTICHE NECESSARIE (a pena di esclusione)		
Caratteristiche		
Dimensioni		


 VB. Ma Or



FORNITURA APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE		
Altezza massima drante il trasporto non superiore a 165 cm.	si	si
larghezza massima durante il trasporto ≤ 70 cm	si	si
lunghezza massima durante il trasporto ≤ 140 cm	si	si
Generatore		
alta frequenza e potenza massima nominale ≥ 30 KV	si	si
range minimo kv: 40 - 10 KV	si	si
massimo prodotto mAs: non inferiore a 300 mAs	si	si
massima corrente (mA) non inferiore a 300 mA	si	si
tempo minimo eposizione non superiore a 0,001 s	si	si
modalità di selezione dei kVp e mAs manuale con programmi9 anatomici memorizzabili	si	si
Sicurezze		
Sovraccarico del tubo	si	si
temperatura monoblocco	si	si


 VB. Han 

FORNITURA APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE		
sovraestensione batterie	si	si
autotest di accensione	si	si
Check dati memoia	si	si
spegnimento completo automatico in caso di inattività superiore a 30 min.	si	si
batterie per la movimentazione e l'esposizione rx		
tempo di ricarica completa con batterie scariche ≤ a 6 ore	si	si
indicatore di carica bassa batteria bassa	si	si
apribile ed ispezionabile, completo di erogatore acqua al bicchiere e alla bacinella	si	si
bacinella in materiale resistente, orientabile, estraibile ed igienizzabile separatamente	si	si
Possibilità di effettuare esposizioni rx anche con cavo di alimentazione collegato alla presa elettrica	si	si
Caratteristiche tubo rx		
Anodo rotante con capacità termica dell'anodo non inferiore a 105 KHU	si	si
Due macchie focali, di cui la più piccola non > 0,6 cm	si	si
misuratore della dose tramite camera DAP	si	si

H VB. *Ma* *Or*

FORNITURA APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE		
Collimatore multi leaf a campo quadro, ruotabile $\geq \pm 90^\circ$, con filtri aggiuntivi Al e Cu e sistema /i per determinare la distanza focale 1 m	si	si
Movimentazione motorizzata apparecchiatura		
motore a velocità variabile, proporzionale alla forza impressa sulla maniglia dell'utilizzatore	si	si
velocità massima in avanti ≥ 1 m/s	si	si
velocità massima indietro $\geq 0,5$ m/s	si	si
presenza di comandi lato-tubo rx per la movimentazione fine in tutte le direzioni	si	si
pendenza massima superabile $\geq 6^\circ$	si	si
Altezza massima di un ostacolo superabile ≥ 3 cm	si	si
freno di stazionamento	si	si
presenza di sistema anti-collisione frontale che arresta l'apparecchiatura	si	si
Movimentazione tubo RX		
colonna porta tubo telescopica e girevole	si	si
rotazione minima del tubo rx intorno all'asse del braccio: $\pm 120^\circ$	si	si
rotazione minima del tubo rx intorno all'asse della colonna dalla posizione di trasporto $\pm 270^\circ$	si	si

VB.  Mkn 

FORNITURA APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE		
rotazione minima del tubo rx intorno al proprio asse +90°/- 10°	si	si
escursione orizzontale del tubo ≥ 30 cm	si	si
distanza minima del fuoco dal pavimento ≤70 cm	si	si
distanza minima del fuoco dal pavimento ≥ 180 cm	si	si
Gestione dell'immagine		
Display touch screen ad alta risoluzione almeno 15", con superficie anti riflesso	si	si
capacità di memorizzazione locale delle immagini: minimo 5.000 immagini non compresse	si	si
acquisizione 16 bit	si	si
Ampio ventaglio di tools per il post processing	si	si
Detettore Digitale flat panel		
dimensione area attiva 35 cm x 43 cm	si	si
dimensione del pixel ≤ 150 micron	si	si
conversione A7D 16 bit	si	si
carico distribuito sull'intera superficie supportato dal detettore non inferiore a 120 kg.	si	si

~~RB.~~

Man

OS

FORNITURA APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE		
peso del detettore non superiore a 3,2 kg.	si	si
sistema completamente wireless	si	si
Connettività del sistema		
prese ETHERNET e USB	si	si
protocolli DICOM con il supporto minimo delle seguenti service classes: print, MPP5, worklist, query/retrieve SCP e storage SCU	si	si
oneri do connessione ed interfacciamento al PACS aziendale a carico della ditta offerente	si	si
Tempi di consegna non superiori a 100 giorni naturali e consecutivi dall'ordine	si	si

Ma

R

VB.

ay



OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

Sistema Sanitario Regione Liguria
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

VERBALE 2

FORNITURA DI UN APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE

DIRETTO

(R.D.O. 2570342)

L'anno 2021 il giorno 01 del mese di marzo alle ore 09.00 presso la sala riunioni dell'U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento di questo Policlinico, sita al primo piano del Padiglione Cotella, si procede alle operazioni di gara relative alla procedura per l'affidamento della fornitura di apparecchio radiologico portatile digitale diretto.

Nel giorno e nell'ora di cui sopra sono presenti i componenti della Commissione Tecnica nominata con determinazione n. 1470 del 02/07/2020 e segnatamente:

PRESIDENTE:	Dott.ssa D. Passerini	Dirigente Medico U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera;
COMPONENTI	Dott. G. Minetti	Dirigente Medico U.O. Radiologia Interventistica
	Ing. M. Saddemi	Dirigente Ingegnere U.O. ICT;
SEGRETERIA	Dott.ssa V. Bertarini	Ass. te Amm.vo U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento



Il Presidente della Commissione, verificata la regolarità della costituzione essendo presenti tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede alla assegnazione del punteggio per ciascun parametro valutativo.

SI ALLEGA AL PRESENTE VERBALE QUALE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE PROSPETTO RELATIVO ALL'ESAME TECNICO DEI PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE.

Allegato 3 alla deliberazione n° 492 del
composto da n° 8 pagine numerate da 1 a

17 MAR. 2021


VB-  

La Commissione, terminato quanto sopra, trasmette copia del presente verbale alla U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento di questo IRCCS per le ulteriori incombenze di competenza.


La Commissione termina i suoi lavori alle ore 10.50.

Letto, confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

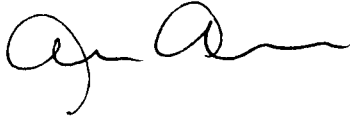

I COMPONENTI




M. Di Caro



Valeria Bertorelli

FORNITURA DI SISTEMA RADIOLOGICO PORTATILE					SIEMENS HEALTHCARE		
CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE		GMM					
		<i>Punti parziali massimi:</i>	<u>DESCRIZIONE</u>	<i>Punti parziali massimi:</i>	<u>DESCRIZIONE</u>		
c.1	range di rotazione del collimatore verrà attribuito il maggior punteggio al dispositivo con il più ampio range	5	+120°/-120°	5	+90°/-90°		
c.2	range minimo del generatore verrà attribuito il maggior punteggio al dispositivo con il più ampio range	5	potenza 40 KW tensione 40-130 KV corrente 70-400 mA tempi 1ms- 3000 ms	5	potenza 35 KW output 450 mA max 133 KV a 225 mA max 450 mA a 54 KV		
c.3	peso dell'apparecchiatura verrà attribuito il maggior punteggio al dispositivo di minor peso	4	435 Kg incluso pacco batterie	4	380 Kg		

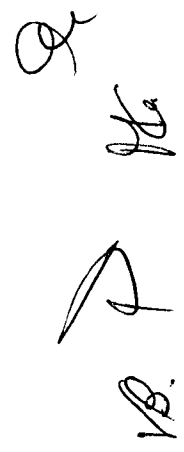

	FORNITURA DI SISTEMA RADIOLOGICO PORTATILE			
	CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	SIEMENS HEALTHCARE		
	GMM			
c.4 dimensioni dell'appercchiatura 4 punti di cui 2 altezza, 1 lunghezza, 1 larghezza verrà attribuito il maggior punteggio al dispositivo di dimensioni più contenute (secondo la suddivisione sopra esposta)	<p>altezza: 135,4 cm lunghezza: 120,4 cm larghezza: 57,6 cm</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>	2	4	<p>altezza : 157 cm profondità: 59,5 cm lunghezza: 127,8 cm</p>
c.5 durata della batteria verrà attribuito il maggior punteggio al dispositivo con la maggior durata della batteria	<p>250 esposizioni RX, 4 km di percorso</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>	4	5	6 ore o 200 immagini (70 KV e 20 mAs)
c.6 capacità di memorizzare le immagini in locale verrà attribuito il maggior punteggio al dispositivo con la maggiore capacità di memorizzare in locale	<p>2 TB e 100.000 immagini</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>	0,4	4	10.000 immagini
c.7 peso del paziente supportato dal detettore verrà attribuito il maggior punteggio al dipositivo in grado di supportare il amggior peso paziente	<p>fino a 340 kg con il supporto detettore per gli esami sotto carico e pazienti bariatrici</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p>	4,4	5	300 kg


 F M
 B.




	FORNITURA DI SISTEMA RADIOLOGICO PORTATILE				
	CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	GMM			SIEMENS HEALTHCARE
c.8	dimensioni del display touch screen verrà attribuito il maggior punteggio al display di più ampie dimensioni	5	5	19 pollici	5 4,5 17 pollici
c.9	tempo di spegnimento completo automatico in caso di inattività verrà attribuito il maggior punteggio al dispositivo con il minor tempo di spegnimento	2	2	dopo 3 minuti modalità sleep mode dopo 60 sec spegnimento completo	2 1 stand by dopo minimo 15 minuti di inattività
c.10	visibilità da parte dell'operatore durante il trasporto verrà attribuito il maggior punteggio al dispositivo che garantisce la miglior visibilità	4	4	ottima visibilità	4 3 buona visibilità
c.11	distanza massima del fuoco dal pavimento verrà attribuito il maggior punteggio al dispositivo con la maggiore distanza	3	2,85	204,5 cm	3 3 213,5 cm

13.10.18


	FORNITURA DI SISTEMA RADIOLOGICO PORTATILE				
	CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	GMM			SIEMENS HEALTHCARE
c.12	velocità massima avanti e indietro verrà attribuito il maggior punteggio al dispositivo con la maggior velocità	3	3	fino a 5km/h indietro fino a 2,5 km/h	da 1,2 a 1,5 m/s
c.13	manovrabilità verrà attribuito il maggior punteggio al dispositivo con la miglior manovrabilità	2	2	ottima manovrabilità	ottima manovrabilità
c.14	presenza di comando infrarossi per l'esposizione rx wireless SI/NO	3	3	si	si
c.15	tempi di consegna verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che garantisce i minor tempi di consegna	4	2	60 gg	60 gg
	CARATTERISTICHE ASSISTENZA TECNICA/FORMAZIONE/GARANZIA OGGETTO DI VALUTAZIONE Assistenza tecnica (RIF, alla scheda di assistenza e manutenzione)				

18.  14a S

	FORNITURA DI SISTEMA RADIOLOGICO PORTATILE				SIEMENS HEALTHCARE		
	CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	GMM					
d.1	vicinanza centro assistenza tecnica e numero verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che dispone del centro di assistenza più vicino	1	1	Genova	1	0,5	Milano
d.2	numero tecnici specializzati di area verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che dispone del maggior numero di tecnici specializzati di area	1	1	2 tecnici in Genova 16 tecnici Bergamo	1	1	5 area nord ovest
d.3	tempi di intervento verrà attribuito il maggior punteggio alla fditta che garantirà il minor tempo di intervento	1	1	1 ora dalla chiamata	1	0	8 ore dalla chiamata
d.4	tempi di risoluzione verrà attribuito il maggior punteggio alla fditta che garantirà il minor tempo di risoluzione	1	1	4 ore lavorative	1	0	3 gg lavorative
d.5	disponibilità di intervento nei giorni festivi	1	0,25	SI da remoto	1	0	NO

VB.   

FORNITURA DI SISTEMA RADIOLOGICO PORTATILE		GMM			SIEMENS HEALTHCARE		
CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE							
d.6	orario di lavoro verrà attribuito il maggior punteggio alla ditta che garantisce i più ampi orari di lavoro	1	1	8-20	1	0,75	lun-ven 8-17 service desk h 24
d.7	formazione (specificare durata e completezza del programma di formazione) verrà attribuito il maggior punteggio al piano formativo più completo esaustivo	2	2	3 gg più attività di affiancamento necessaria nel periodo di garanzia	2	1,75	2 gg con teoria e pratica piano completo ed esaustivo
d.8	garanzia verrà attribuito il punteggio massimo alla ditta che avrà offerto la massima estensione di garanzia in aggiunta ai 24 mesi previsti obbligatoriamente. Alle altre ditte sarà assegnato un punteggio in amniera inversamente proporzionale	3	3	36 mesi	3	0	24 mesi
TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO			65,6			48,55	
TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO RIPARAMETRIZZATO			70			51,81	

M. S.

V.B.

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2570342
Descrizione RDO:	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Modalità di calcolo della soglia di anomalia:	La congruità è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti)
Amministrazione titolare del procedimento	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO 02060250996 LARGO ROSANNA BENZI, 10 GENOVA GE
Punto Ordinante	STEFANIA RIZZUTO
Soggetto stipulante	Nome: STEFANIA RIZZUTO Amministrazione: IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Non disponibile
Inizio presentazione offerte:	19/05/2020 11:43
Termine ultimo presentazione offerte:	10/06/2020 18:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	29/05/2020 18:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	31/12/2020 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	60
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della Rdo:	BENI/Forniture specifiche per la Sanità

Lotto esaminato: 1 APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO

CIG	827301866C
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	APPARECCHIO RADIOLOGICO PORTATILE DIGITALE DIRETTO/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	82000,00000000

Allegato ^H alla deliberazione n° ⁴⁹⁹ del
composto da n° ³ pagine numerate da 1 a

17 MAR. 2021

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Singola	12268050155	08/06/2020 12:19
2	GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	Singola	00225500164	09/06/2020 09:23

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	11/06/2020 09:32:43	10/11/2020 13:29:26

Non esistono Richieste Amministrative di Gara

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ART. 4 COMMA A) DELLE CONDIZIONI PARTICOLATI		ALLEGATO M7 (GDPR)		DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	10/11/2020 13:29:34	05/03/2021 09:00:15

Concorrente	QUESTIONARIO TECNICO COMPILATO		DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA PRODOTTO OFFERTO		SCHEDA ASSISTENZA POST-VENDITA COMPILATA		DESCRIZIONE TECNICA PRODOTTO OFFERTO		OFFERTA ECONOMICA SENZA PREZZI	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
--	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	05/03/2021 09:07:14	05/03/2021 09:14:37

Concorrente	LISTINO PREZZI IN CORSO DI VALIDITA'		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.	69800,00000000	0,00	70,00	30,00	100,00
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	77000,00000000	0,00	51,81	27,19	79,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento
Direttore U.O.: Dott.ssa S. Rizzuto
Responsabile procedimento: Dott. M. Rossi

Spett.le Ditta GMM
rosangela.zenoni@pec.gmmspa.com

OGGETTO: Procedura di gara per la fornitura apparecchio digitale portatile diretto

A seguito dell'apertura delle offerte economiche relativa alla procedura di gara di cui all'oggetto avvenuta in data 05/03/2021, si comunica che l'offerta presentata da Codesta Spettabile Ditta risulta essere anomala ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si invita, pertanto, a voler far pervenire alla scrivente idonee precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta.

In particolare, si chiede di chiarire l'economia del processo di fabbricazione, le soluzioni tecniche adottate, nonché le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone Codesta Spettabile Ditta per fornire l'apparecchiatura oggetto di gara, unitamente al dettaglio di tutte le altre voci di costo che hanno determinato il valore economico di dette offerte.

Tali giustificazioni dovranno pervenire per iscritto alla scrivente con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Stefania Rizzuto)

Allegato 5 alla deliberazione n° 197 del 17 MAR. 2021
composto da n° 1 pagine numerate da 1 a



Prot. n. 200220/21
10 MAR 2021

Spett. le
I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino
- U.O. Attività Economiche e di Approvvigionamento -
Largo R. Benzi, 10
16132 – Genova (GE)-

c.a.: Dott.ssa S. Rizzuto

Prot. n. 200220/GG/am
Seriata (BG), 09/03/2021

**OGGETTO: Vostro Prot. Generale n. 0010782/21 del 08/03/2021.
R.D.O. su M.E.P.A. per la fornitura in urgenza per la gestione in
emergenza di pazienti affetti da CORONAVIRUS (2019-nCoV) di n. 1
Apparecchio Radiologico portatile Digitale Diretto.
R.d.O. N. 2570342 – CIG: 827301866C.**

GIUSTIFICAZIONE PREZZI PER I PRODOTTI OFFERTI - art. 97 comma 5 del D. Lgs 50/2016

Relativamente alla Vostra richiesta di verifica di congruità in oggetto di seguito le relative giustificazioni,

PROSPETTO COSTI AI FINI DELLA GIUSTIFICAZIONI DEI PREZZI DELLA NOSTRA OFFERTA

PREZZO IN OFFERTA Euro 69.800,00		COSTO €	INCIDENZA %
1	COSTO LAVORO	3.543,00	5,08%
2	COSTO ATTREZZATURE -MATERIALI	52.119,00	74,67%
3	COSTI GENERALI	1.250,00	1,79%
4	COSTI DELLA SICUREZZA	698,00	1,00%
5	UTILE d'IMPRESA	12.190,00	17,46%
TOTALE Euro		69.800,00	100,00%
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) determinati da codesta stazione appaltante Euro		0,00	
Totale offerta Euro		69.800,00	

A - Con riferimento alle materie prime.

La General Medical Merate SpA (più avanti GMM), opera nel settore da oltre 60 anni ed impiega oltre 250 lavoratori distribuiti sul Gruppo.

Si avvale per l'acquisizione delle materie prime di fornitori selezionati, considerato l'alto livello tecnologico in cui opera.

GENERAL MEDICAL MERATE SpA

Azienda certificata

Stabilimento Sede legale e amministrativa: Via Partigiani, 25 • 24069 Seriate BG Italy
Tel: +39 035 4525311 • Fax: +39 035 2997757 • Assistenza Tecnica Fax: +39 035 4525367 • WEB: www.gmmspa.com
L. Biava Via Viraboni 11 • 20114 Roma Italy • Tel: +39 06 8274437 • Fax: +39 06 8274455 • E-mail: gmm@italica.com
Stabilimento Viale Unità d'Italia 40 • 70020 Cascano delle Morge BA • Tel: +39 080 7755410 • Fax: +39 080 764306
Partita I.V.A. Codice Fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225300164 • Minicomis S. BG 12002159
C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 158291 • C.C. Postale 15218241 • R.A.E.E. IT0902000000063 • Registro P.I.e. BG-000016



Allegato ⁶ alla deliberazione n° 492 del
composto da n° ¹ pagine numerate da 1 a

17 MAR 2021



Parte delle materie prime sono acquisite, oltre che in Italia, su mercati europei ed extra europei, come la componentistica relativa al gruppo di alta tensione e quella relativa ai detettori flat panel.

I volumi trattati consentono alla nostra Azienda di negoziare contratti importanti in termini di prezzo con economie che si riflettono sul prodotto finale.

Si avvale inoltre di collaborazioni per le lavorazioni in conto terzi di aziende specifiche per ogni tipologia o caratteristica necessaria a realizzare alcuni componenti finalizzati alle varie tipologie di prodotti.

La produzione industriale con i relativi percorsi, pensati e realizzati per assicurare un'alta qualità delle apparecchiature, avviene nei propri stabilimenti di Seriate (Bergamo), di Cassano delle Murge (Bari), di Lissone (Monza) ed in altri stabilimenti di Aziende del Gruppo interamente partecipate.

Il nostro sistema produttivo dalla progettazione all'acquisizione delle materie prime, ai processi di produzione, al montaggio ed al collaudo delle apparecchiature è certificato secondo le norme **UNI EN ISO 13485**.

Nel caso specifico l'apparecchiatura è prodotta in OEM da un costruttore esterno per cui sono stati conteggiate le sole attività interne, controllo verifica e procedure di accettazione e spedizione messa in funzione e attività in garanzia.

B – Con riferimento al costo del personale.

La GMM SpA applica al proprio personale il costo del lavoro come **determinato dal CCNL settore Metalmeccanico**, periodicamente aggiornato in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale.

Si dichiara inoltre di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei salari e dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana.

C – Con riferimento alle spese Generali.

Si premette che i bilanci della nostra Azienda da oltre 10 anni sono certificati da primaria Società di certificazione specifica (KPMG S.p.A.), e regolarmente depositati.

La nostra Azienda essendo una S.p.A. dispone di tutti gli organi di controllo e sorveglianza per quanto riguarda le attività relative allo scopo societario e per ciò che riguarda la stesura del bilancio vengono applicate le regole della contabilizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

Tra l'altro segnaliamo che nel compilare il Bilancio 2018 gli Amministratori hanno voluto evidenziare, con voce specifica, le spese sostenute per la sicurezza e la salute sui posti di lavoro al fine di sottolineare che la "sicurezza aziendale" è una priorità.

Il calcolo delle spese generali comprendono tutte quelle che servono alla gestione della nostra attività produttiva, tecnica e commerciale.

GENERAL MEDICAL MERATE SpA

Stabilimento Sede legale e amministrativa, Via Panighian, 23 • 24069 Seriate BG Italy
Tel. +39 033 4525311 • Fax +39 035 2997787 • Assistenza Tecnica Fax +39 033 4525367 • WEB: www.gmmspa.com
Ufficio Via Traboschi, 78-11 • 00141 Roma Italy • Tel. +39 06 8274437 • Fax. +39 06 8274455 • E-mail: comunicazione@gmmspa.com
Stabilimento Sede Unità d'Italia 40 • 70029 Cassano delle Murge BA • Tel. +39 080 773840 • Fax. +39 080 764300
Partita I.V.A. Codice fiscale e Registro Imprese di BG n° 00225300104 • Minicones N. BG 12002139
C.C.I.A.A. R.E.A. Bergamo 138291 • C.C. Postale 15218241 • R.A.E. IT08020000000065 • Registro Ptk BG-000016

Azienda certificata



ISO9001:2015

ISO13485:2016

